CellSep® PLX-5A 사용설명서 그리고 ※ 유의사항

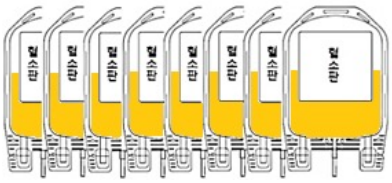

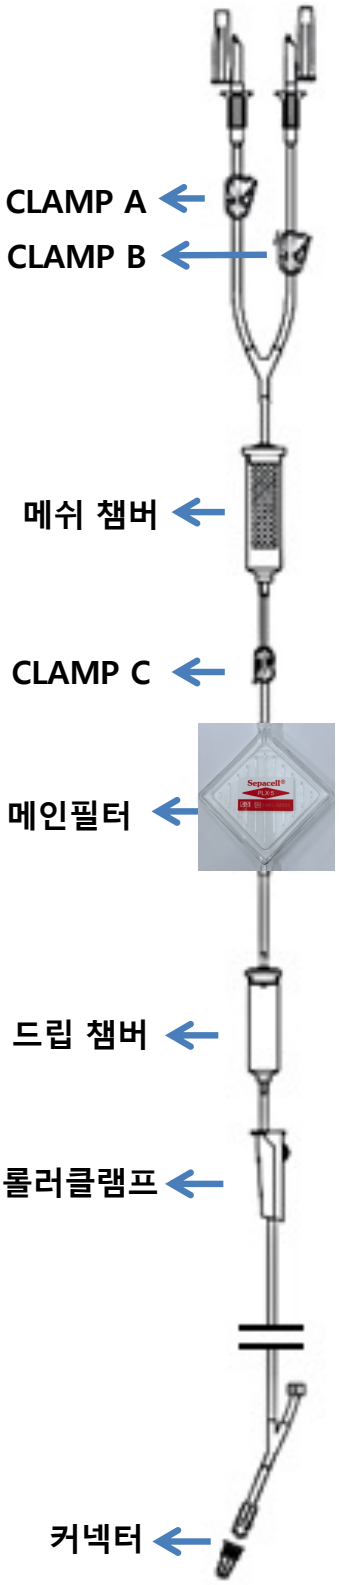

1. 제품을 개봉하고 모든 클램프 를 닫는다.

2. 스파이크의 보호 캡을 제거하고 부드럽게 양 방향으로 번갈아 돌리면서 혈소판 백에 연결한다.

   ※ 스파이크를 한 방향으로 계속 돌리지 않는다.

   두개의 튜빙 라인 중에 하나의 라인으로 사용하는 것을 권장한다.

3. 혈액백을 IV 스탠드에 걸고 두개의 라인 중에 혈액백에 연결된 하나의 라인의 CLAMP A 혹은 B를 연다.(구분이 없는 동일한 클램프입니다.)

4. CLAMP C가 CLOSED 된 상태로

   메쉬 챔버를 한 두 번 정도 눌러서 1/3 정도를 채워준다.

메인 필터의 프라임

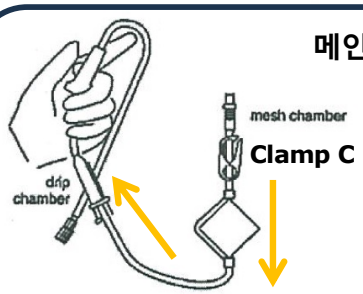

메인 필터를 그림과 같이 중력방향으로 위치하여 프라임한다.

그렇지 않으면 필터내의 공기가 제거되지 않는다.

4. Clamp C를 열어준 후 드립 챔버를 거꾸로 들고 롤러클램프를 조금씩 천천히 열어 드립 챔버에 ½ 정도 거꾸로 채운 후 롤러클램프를 닫는다.

7. 드립 챔버를 중력 방향으로 내린다.

   이 후 수혈과정에서 드립 챔버를 손으로 누르지 않는다.

8. 롤러 클램프를 열어 드립 챔버 부터 루어락 커넥터부분 까지 튜빙 라인을 프라임 한다. 롤러 클램프를 완전히 잠그고 I.V Catheter 에 커넥터를 이용하여 연결 한 후 롤러 클램프를 조절 하여 수혈한다.

※ 혈액백을 교체하는 경우 튜빙라인이 완전히 비워지기 전에 연결해야 한다. 튜빙라인이 비워지게 되면 메인필터에 공기가 차게 되어 프라임을 다시 하거나 필터세트를 교체 해야 하는 경우도 있다.