CellSep PLX-5NP 사용설명서 그리고 ※ 유의사항

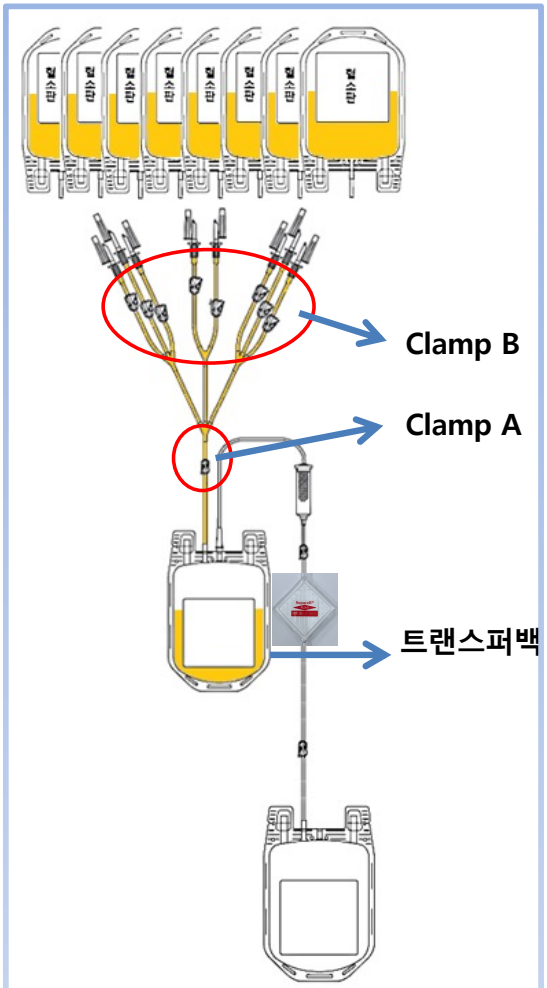

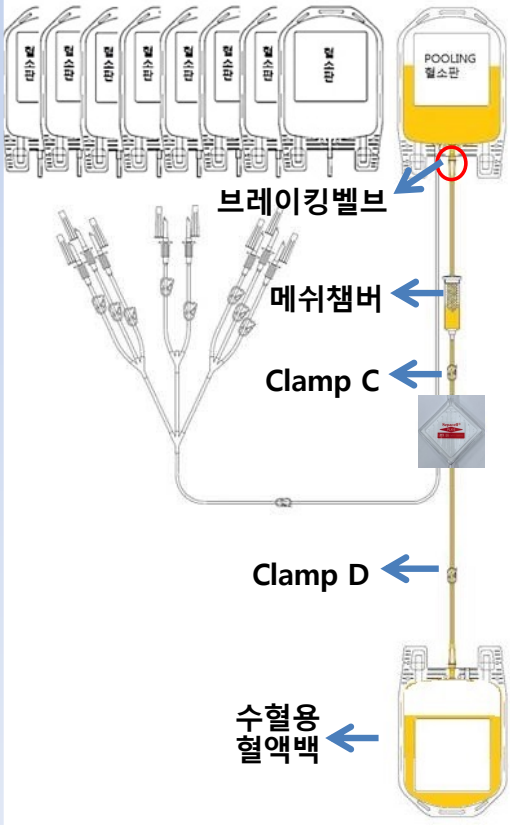

1. 제품을 개봉하고 모든 클램프 를 닫는다.
2. 스파이크의 보호 캡을 제거하고 부드럽게 양 방향으로 번갈아 돌리면서 혈소판 백에 연결한다. ※ 스파이크를 한 방향으로 계속 돌리지 않는다.
3. 각각의 혈액백을 IV stand에 걸고 Clamp A와 Clamp B를 차례로 열어 혈소판을 트랜스퍼백에 모아 준 후 Clamp A를 닫는다.
4. 트랜스퍼백을 반드시 부드럽게 2~3 차례 흔들어 섞은 후에 IV stand에 건 후 브레이킹벨브를 두손으로 잡고 두차례 소리가 나게 각각 다른 방향으로 꺾어서 완전히 부러뜨린다.

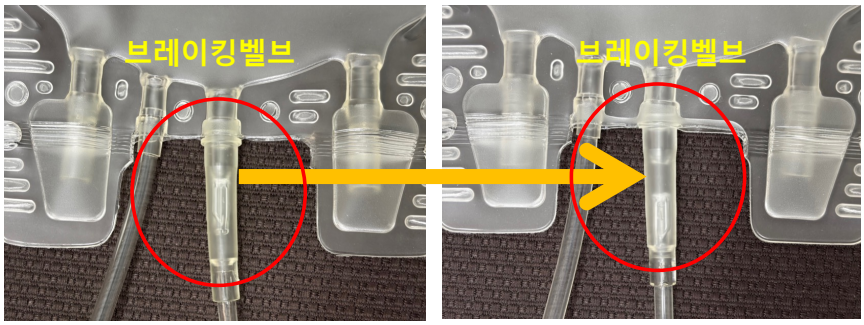

※ 브레이킹 벨브가 완전히 부러리지 않는 경우 막힘의 원인이 된다.

5. 반드시 CLAMP C가 CLOSED 된 상태로 메쉬 챔버를 한 두 번 정도 눌러서 1/3 정도를 채워준다.
6. 필터를 중력방향으로 내린상태에서 Clamp C와 D를 열어 필터를 통과 시켜 백혈구가 제거 된 혈액을 수혈용 혈액백으로 모은다.

※ 수혈도중 부득이하게 필터 막힘 현상이 일어나서 세트를 더 이상 사용하지 못하는 경우에는 Port 1나 port2에 다른 키트를 연결하여 수혈 할 수 있다.

제품의 필터 하단 튜빙에 자동 유량속도 조절장치가 장착되어 있어 최적의 속도로 제어 된다.

혈소판 6 unit 기준으로 5~6분 소요가 일반적이며 혈액 상태에 따라 다를 수 있다.